5973 Autotune

Instrument: MSD 20
Thu Aug 03 16:00:37 2006 D:\MSDCHEM\1\5973N\ATUNE.U

Mass	69.00	Mass	218.90	Mass	502.00
Ab	483164	Ab	247349	Ab	17083
Pw50	0.62	Pw50	0.62	Pw50	0.64

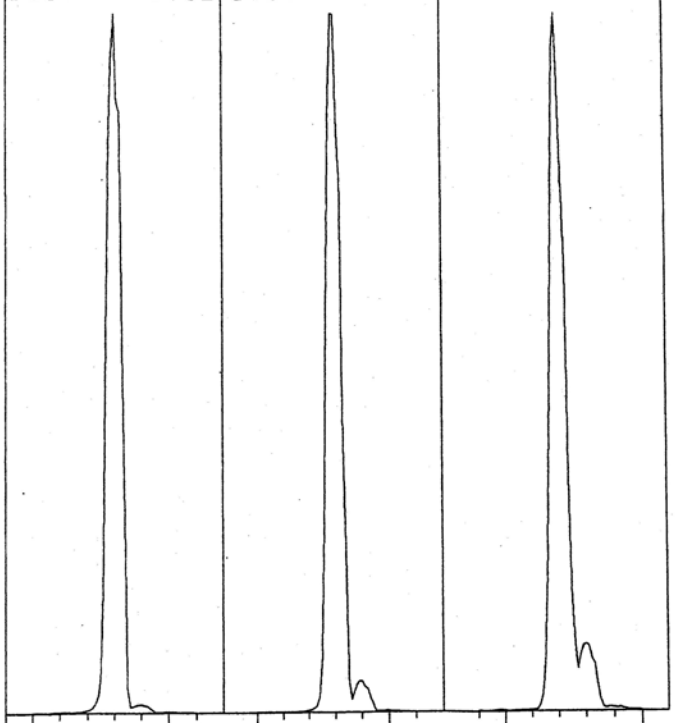

Ion Pol	POS	MassGain	397
		MassOffs	-10
Emission	34.6	AmuGain	2576
EleEnergy	69.9	AmuOffs	127
Filament	1	Wid219	-0.018
		DC Pol	NEG
Repeller	30.46		
IonFocus	90.2	HED	ON
EntLens	11.5	EMVolts	1353
EntOffs	19.33		
		Samples	8
PFTBA	OPEN	Averages	3
		StepSize	0.10

Zones:

MS Source	230	Foreline	59
MS Quad	150		

Scan: 10.00 - 700.00 Samples: 8 Thresh: 100 Step: 0.10
166 peaks Base: 69.00 Abundance: 439872

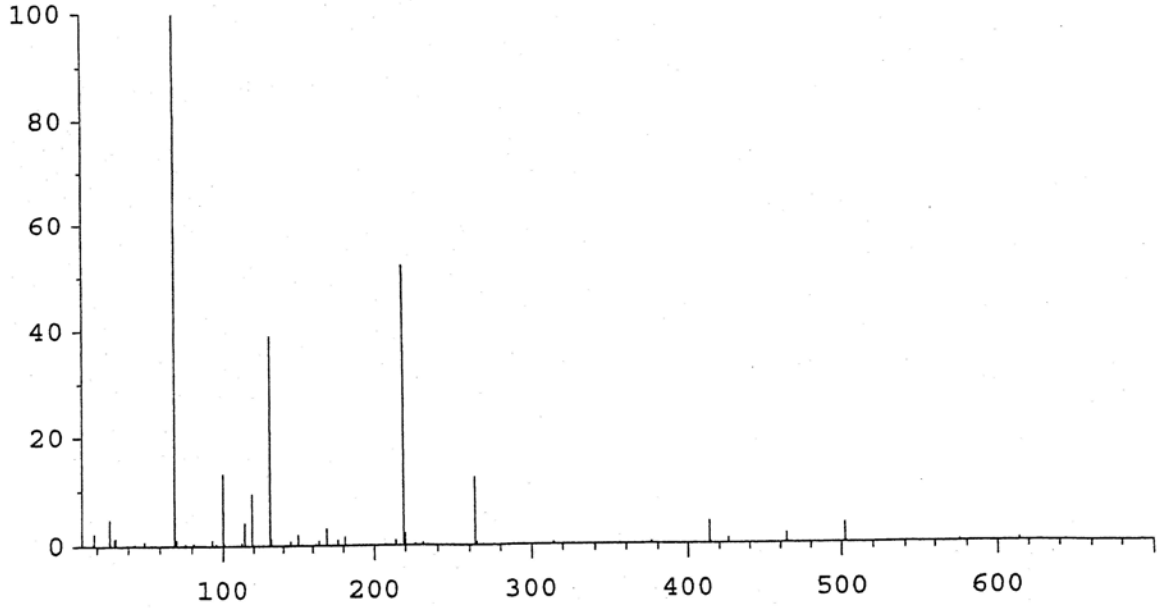

Mass	Abund	Rel Abund	Iso Mass	Iso Abund	Iso Ratio
69.00	439872	100.00	70.00	5101	1.16
219.00	230080	52.31	220.00	10123	4.40
502.00	15730	3.58	502.90	1442	9.17